VAGLIENTI BEAUTÉ

OVALIFT

Appareil de massage technologique visage, cou et corps



OVALIFT transpose le massage gua sha en un soin technologique dédié au visage et au corps. Micro-courants, EMS, chaleur à 42 °C, vibration intelligente et photothérapie LED se répartissent entre 3 modes ciblés. Son galbe suit les zones étendues tandis que sa pointe affinée travaille les contours avec précision.

Important

- Lire entièrement cette notice avant la première utilisation et la conserver.
- OVALIFT est un appareil cosmétique destiné à un usage personnel à domicile. Il ne remplace pas un dispositif médical ni l'avis d'un professionnel de santé.
- Utiliser l'appareil uniquement sur une peau saine, intacte et non irritée.
- Commencer au niveau 1, puis augmenter progressivement selon le confort de la peau et de la zone travaillée.
- Ne jamais utiliser l'appareil pendant la charge.
- OVALIFT n'est pas étanche. Ne pas le rincer, l'immerger ou l'utiliser dans un environnement très humide.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse. Fermer les yeux lors d'un passage à proximité du contour de l'oeil.
- Arrêter immédiatement en cas de douleur, brûlure, rougeur persistante, vertige ou inconfort inhabituel.

1. Démarrage rapide

01
Charger l'appareil
Charger complètement OVALIFT avant la première utilisation avec le câble USB-C fourni.

02
Préparer la peau
Nettoyer la zone, puis appliquer un gel conducteur ou un soin offrant une glisse régulière.

03
Allumer
Maintenir le bouton marche / mode environ 2 secondes. OVALIFT démarre en WARM, au niveau 1.

04
Choisir le mode
Appuyer brièvement sur marche / mode pour passer de WARM à MSG, puis à MOIST.

05
Régler l'intensité
Commencer au niveau 1, puis passer aux niveaux 2 ou 3 si la sensation reste confortable.

06
Poser les contacts
En WARM et MOIST, garder le galbe et la pointe simultanément contre la peau.

07
Tracer le passage
Visage : intérieur vers extérieur, bas vers haut. Corps : mouvements plus longs.

08
Nettoyer et ranger
Chaque mode dure 10 minutes. Éteindre, essuyer les contacts et ranger au sec.

2. Structure de l’appareil et contenu

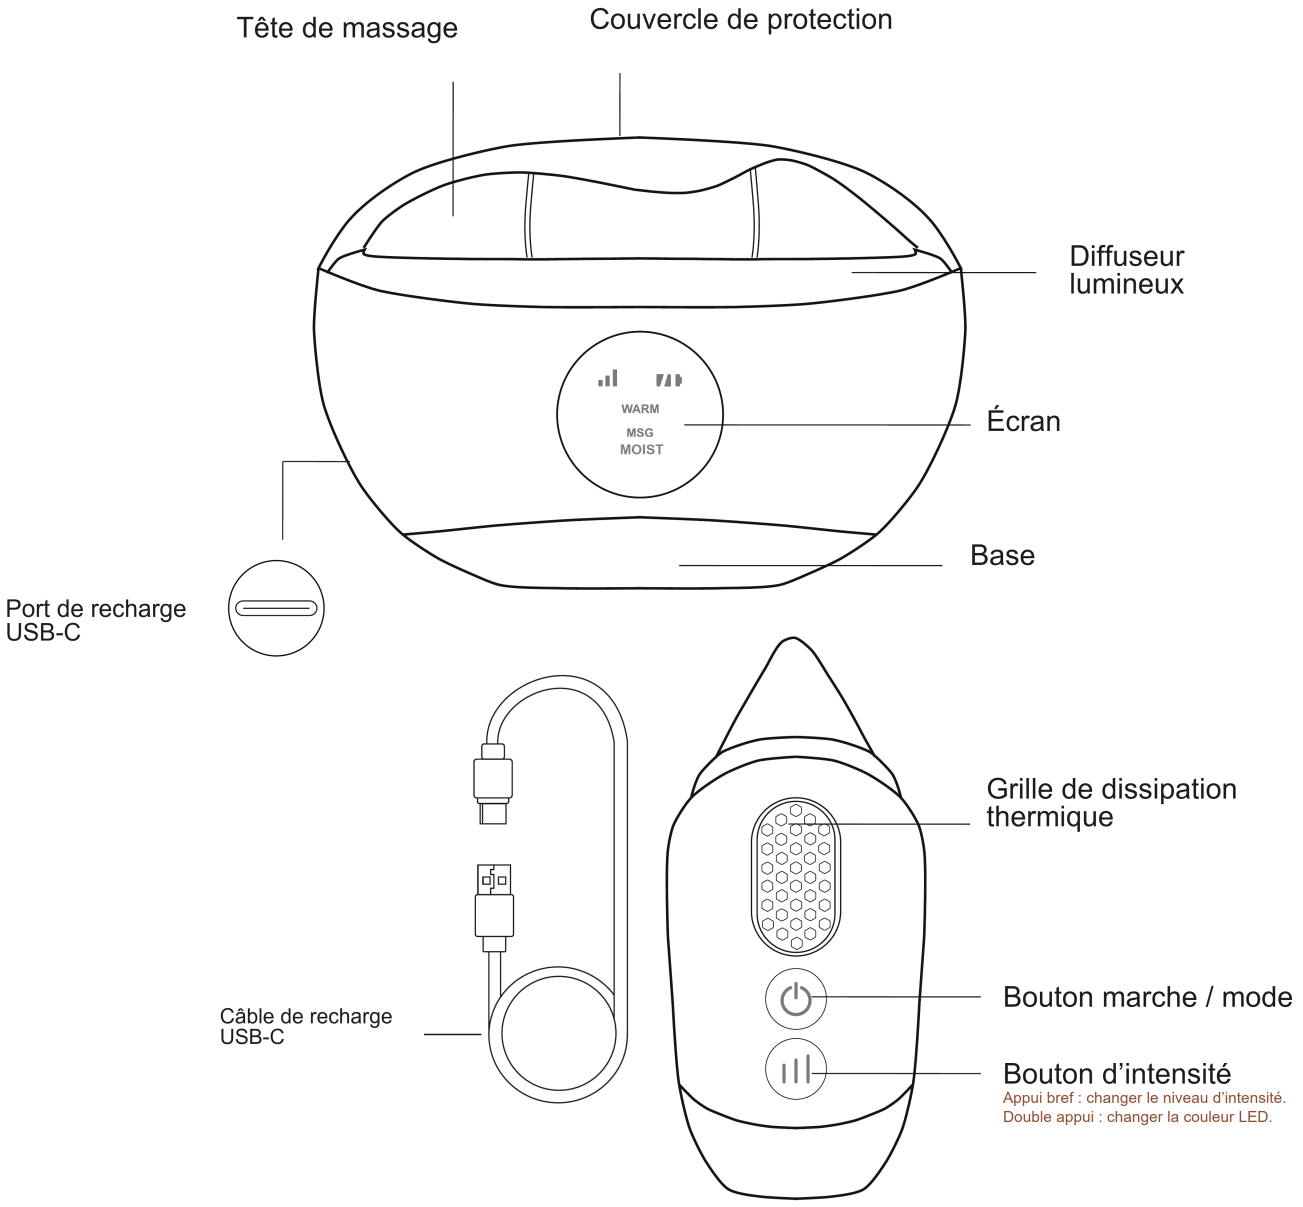

Contenu du coffret

Appareil OVALIFT

Un appareil complet pour le visage, le cou et le corps.

Câble USB-C

Le câble de recharge USB-C est fourni avec l’appareil.

3. Fonctions principales

Fonction	Réglage	Rôle dans le rituel
Micro-courants	WARM, 3 niveaux	Stimulation douce pendant le massage chauffant.
EMS	MSG et MOIST, 3 niveaux	Impulsion plus nette pour accompagner la tonicité des tissus.
Chaleur	42 °C, WARM et MOIST	Chaleur constante pendant le passage.
Vibration	9 000 tr/min, WARM et MOIST	Déclenchement au contact simultané des deux zones conductrices.
Photothérapie LED	Rouge, bleu et 7 couleurs en MOIST	Associe la lumière au mode et à l'intention de soin.

4. Commandes, écran et modes

Commande	Action
Marche / mode	Maintenir environ 2 secondes pour allumer ou éteindre. Appuyer brièvement pour faire défiler WARM, MSG et MOIST.
Intensité	Appuyer brièvement pour faire défiler les niveaux 1, 2 et 3. Les niveaux règlent la force de l'impulsion électrique, jamais la température.
Couleurs LED	En MOIST, effectuer deux appuis rapides sur le bouton intensité pour faire défiler les couleurs LED.
Vibration	En WARM et MOIST, la vibration se déclenche automatiquement lorsque les deux contacts touchent simultanément la peau.

Lecture de l'écran

Les barres de gauche indiquent le niveau d'intensité sélectionné. Les trois segments de droite indiquent le niveau de batterie restant : ils s'éteignent progressivement à mesure que la batterie se décharge. Le nom affiché en noir correspond au mode actif.



WARM

42 °C, micro-courants, vibration au contact et LED rouge 630 nm.



MSG

EMS et LED bleue 470 nm, sans chaleur ni vibration.



MOIST

42 °C, EMS, vibration au contact et 7 couleurs LED.

5. Utilisation pas à pas

01

Créez la glisse

Nettoyez la zone, puis appliquez un produit adapté à la conduction et au mode choisi. Pour MOIST, utilisez un sérum, une essence ou une formule offrant une glisse continue.

02

Choisissez la sensation

Sélectionnez WARM pour la chaleur et les micro-courants, MSG pour une EMS plus franche ou MOIST pour travailler simultanément la peau et la formule appliquée.

03

Montez par paliers

Commencez au niveau 1. Passez au niveau 2, puis au niveau 3 lorsque la zone et votre confort le permettent.

04

Posez les deux contacts

En WARM et MOIST, maintenez simultanément la surface galbée et la pointe contre la peau pour déclencher la vibration.

05

Tracez le passage

Visage : de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut.
Corps : mouvements plus longs qui suivent les courbes.

06

Travaillez 10 minutes

Gardez l'appareil en mouvement et revenez progressivement sur les lignes qui demandent davantage de précision.

Pression et confort

- Le geste doit rester lent, continu et confortable.
- Ne pas appuyer fortement et ne pas maintenir la tête métallique immobile sur une même zone.
- Une légère sensation de picotement ou une contraction ponctuelle peut apparaître. Diminuer l'intensité si la sensation devient désagréable.
- Ajouter du produit si la glisse diminue pendant la séance.

6. Zones et gestes

Zone	Geste conseillé
Visage	Travailler de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut. Utiliser la pointe autour des reliefs et le galbe sur les joues et l'ovale.
Cou	Effectuer des mouvements réguliers et légers sur les côtés et l'arrière du cou. Éviter toute pression excessive.
Bras et mains	Suivre les lignes musculaires par des passages lents et continus.
Taille et hanches	Utiliser la surface galbée pour des mouvements amples adaptés aux courbes.
Jambes	Remonter par mouvements longs, sans insister sur une zone sensible ou douloureuse.
Dos	Faire guider l'appareil par une autre personne si la zone n'est pas accessible sans tension ni torsion.

7. Les 7 couleurs LED du mode MOIST

Couleur	Longueur d'onde	Intention
Rouge	630 nm	Anti-âge, lisse les rides.
Jaune	590 nm	Éclat, réveille le teint.
Vert	550 nm	Harmonie, unifie le teint.
Cyan	490 nm	Confort, apaise les sensibilités.
Bleu	470 nm	Peau nette, purifie la peau.
Violet	420 nm	Pureté ciblée, cible les imperfections.
Blanc	-	Soin global, ravive l'apparence générale.

8. Rythme conseillé

01

Première utilisation

Commencer au niveau 1 afin d'observer la réaction de la peau et la sensation électrique.

02

Progression

Passer aux niveaux 2 puis 3 uniquement lorsque le niveau précédent reste confortable.

03

Durée

Chaque mode propose un cycle de 10 minutes.

04

Fréquence

Une peau saine qui tolère bien l'appareil peut évoluer jusqu'à une séance quotidienne. Commencer progressivement.

05

Après la séance

Éteindre l'appareil, retirer l'excédent de produit si nécessaire et poursuivre avec les soins habituels.

9. Recharge



- Éteindre OVALIFT. Ne jamais utiliser l'appareil pendant la charge.
- Vérifier que le port USB-C et le câble sont parfaitement secs.
- Connecter le câble USB-C fourni à l'appareil, puis à une alimentation USB adaptée.
- Le voyant clignote pendant la charge et reste fixe lorsque la batterie est pleine.
- Une recharge complète dure environ 2 heures.
- Débrancher le câble lorsque la charge est terminée.

10. Nettoyage, entretien et stockage

- Éteindre et débrancher l'appareil avant le nettoyage.
- Essuyer la tête métallique et les surfaces externes avec un chiffon doux légèrement humide.
- Retirer soigneusement tout résidu de gel, de sérum, d'essence ou de soin après chaque utilisation.
- Sécher complètement l'appareil et le port USB-C avant rangement ou recharge.
- Ne pas rincer OVALIFT, ne pas l'immerger et ne pas le nettoyer sous l'eau courante.
- Ne pas utiliser d'alcool agressif, de solvant, de produit abrasif ou de détergent corrosif.
- Ne pas faire tomber, heurter, percer, démonter ou modifier l'appareil.
- Ranger OVALIFT dans un endroit sec, propre, tempéré et hors de portée des enfants.

11. Précautions et contre-indications

- Ne pas utiliser sur une plaie, une lésion ouverte, une brûlure, une infection, une inflammation active ou une zone douloureuse.
- Ne pas utiliser avec un pacemaker, un dispositif médical implanté ou un implant électronique sans avis médical.
- En cas de grossesse, d'épilepsie, de maladie cardiaque, de cancer, de trouble important de la tension, de traitement médical ou de doute, demander l'avis d'un professionnel de santé avant utilisation.
- Ne pas utiliser en cas de fièvre, de maladie aiguë ou lorsque l'état général ne permet pas un soin confortable.
- Ne pas regarder directement la lumière. Fermer les yeux lorsque la tête s'approche du contour de l'oeil.
- Retirer les bijoux et accessoires métalliques proches de la zone travaillée.
- Ne pas utiliser avec un câble endommagé, après une chute importante, en présence d'une fissure, d'une odeur anormale ou d'un échauffement inhabituel.

- Arrêter immédiatement l’appareil en cas de chaleur anormale afin d’éviter tout risque de brûlure.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil. Conserver OVALIFT et son câble hors de leur portée.

12. Dépannage rapide

Situation	Causes possibles	À faire
L’appareil ne s’allume pas	Batterie déchargée ou appui trop court.	Recharger OVALIFT, puis maintenir marche / mode environ 2 secondes.
L’intensité semble faible ou irrégulière	Contact incomplet, produit insuffisant ou niveau trop bas.	Replacer les deux contacts, ajouter du produit et ajuster progressivement l’intensité.
La vibration s’arrête pendant le mouvement	L’une des deux zones conductrices ne touche plus la peau.	Ajuster l’angle afin que le galbe et la pointe restent simultanément en contact.
La vibration ne fonctionne pas en MSG	Fonctionnement normal.	La vibration intervient uniquement en WARM et en MOIST.
La chaleur n’est pas perceptible en MSG	Fonctionnement normal.	MSG fonctionne à température ambiante, sans chaleur.
La sensation électrique est trop forte	Intensité élevée, peau sensible ou glisse insuffisante.	Revenir au niveau 1, ajouter du produit et interrompre si l’inconfort persiste.
L’appareil ne charge pas	Câble mal branché, alimentation inadaptée ou port humide.	Vérifier les branchements, sécher le port USB-C et réessayer.

13. Caractéristiques techniques

Élément	Donnée
Nom du produit	OVALIFT
Zones	Visage, cou et corps
Fréquence EMS	2 900 Hz
Modes	WARM, MSG, MOIST
Intensités	3 niveaux pour chaque mode
LED	Rouge 630 nm, jaune 590 nm, vert 550 nm, cyan 490 nm, bleu 470 nm, violet 420 nm, blanc
Chaleur	42 °C, modes WARM et MOIST
Vibration	9 000 tr/min, déclenchée au contact de la peau
Séance	10 minutes par mode
Batterie	600 mAh
Recharge	USB-C, environ 2 heures
Protection	Non étanche, sans rinçage ni immersion
Dimensions	116 x 80 x 36 mm
Poids	128 g
Contenu du coffret	Appareil OVALIFT, câble de recharge USB-C

14. Recyclage, garantie et service

En fin de vie, ne jetez pas OVALIFT avec les déchets ménagers. Déposez-le dans un point de collecte adapté aux équipements électriques et électroniques.

OVALIFT bénéficie d'une garantie commerciale de deux ans à compter de la date d'achat, sous réserve d'une utilisation conforme à cette notice.

La garantie ne couvre pas les dommages liés à une chute, une immersion, un démontage, une modification, une mauvaise alimentation électrique ou une utilisation non conforme.

15. Responsable de la mise sur le marché UE

Élément	Information
Responsable de la mise sur le marché UE	Vaglienti Beauté
Adresse postale	1055 Budapest, Szent István körút 27., 1. em. 7. ajtó, Hongrie
Contact	support@vaglienti-beaute.com
Page produit	https://vaglienti-beaute.com/ovalift.html

Scannez le QR code pour retrouver la page produit OVALIFT, les conseils d'utilisation et les informations mises à jour.